



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
terstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, tel.: 91 43 29 503 lub 500, fax 91 43 29 501

www.spzozmswia.szczecin.pl biuro@spzozmswia.szczecin.pl

BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757

Szczecin, dnia 24 czerwca 2019 r.

WTG-2375-17-.....-05/19

WYJAŚNIENIE NR 1

Dotyczy: postępowania przetargowego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), pn.: „Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych sprzętów oraz urządzeń aparatury medycznej dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania do SIWZ o następującej treści (wg kolejności wpływu):

Pytanie nr 1: dot. Pakietu nr 9

Czy z uwagi na zalecenia producenta skanera CR Max Carestream Health odnośnie czasu pomiędzy przeglądami – 6 miesięcy, Zamawiający zmieni ilość przewidywanych przeglądów w okresie obowiązywania umowy z 2 na 4?

Odpowiedź nr 1:

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostały odpowiednio zmodyfikowane.

Pytanie nr 2: dot. Pakietu nr 9

Ostatni przegląd w urządzeniu skaner CR Max Carestream Health odbył się w dniu 24 marca 2019 r., czy Zamawiający zmieni datę kolejnego przeglądu z 24 czerwca 2019 r. na 24 września 2019 r.? Czas pomiędzy kolejnymi przeglądami, zgodnie z zaleceniami producenta Carestream Health wynosi 6 miesięcy.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 3: dot. rozdziału II, pkt 1.5. SIWZ w zakresie Pakietu nr 9

„Do realizacji usługi Wykonawca winien oddelegować osobę posiadającą niezbędne do jej wykonania odpowiednie kwalifikacje”. Jakiego rodzaju „odpowiednie kwalifikacje” ma na myśli Zamawiający? Czy Zamawiający wymaga, aby pracownicy wykonujący przeglądy i naprawy posiadali certyfikaty odbycia szkolenia serwisowego na skaner CR Max wydany przez centrum szkoleniowe producenta Carestream Health?

Odpowiedź nr 3:

Przez sformułowanie „odpowiednie kwalifikacje” Zamawiający rozumie fakt posiadania przez osobę oddelegowaną do przeprowadzenia przeglądów technicznych właściwych sprzętów i urządzeń aparatury medycznej doświadczenia przy realizacji tego typu usług.

Pytanie nr 4: dot. Pakietu nr 18 oraz Pakietu nr 20

W opisie przedmiotu zamówienia w pkt 1.5. Zamawiający do realizacji usługi wymaga osoby posiadającej niezbędne kwalifikacje. Czy w związku z powyższym Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia imiennych certyfikatów ze szkoleń na dany rodzaj sprzętu.

Odpowiedź nr 4:

Nie. Nadto Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.



Pytanie nr 5: dot. Pakietu nr 20

Dla przeprowadzenia przeglądu aparatu Evita V300 z Pakietu nr 20 wykonujący potrzebuje zgodnie z zaleceniami producenta opisanymi w instrukcji serwisowej specjalistycznego oprogramowania serwisowego „Service Connect”. Czy Zamawiający w celu potwierdzenia posiadania takiego oprogramowania serwisowego będzie wymagał od wszystkich Wykonawców przedstawienia wydruku z programu „ServiceConnect” z listą użytkowników programu serwisowego, którzy są w dyspozycji składającego ofertę?

Odpowiedź nr 5:

Nie.

Pytanie nr 6: dot. rozdziału I, działu 8., pkt 8.1. SIWZ

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem: „Ryczałt za jednorazowy dojazd do siedziby Zamawiającego”, który jest jednym z kryterium oceny? Ryczałt ten dotyczy przyjazdu do siedziby Zamawiającego na przegląd okresowy jednorazowy, którego dotyczy dany Pakiet, czy dodatkowego przyjazdu w przypadku np. diagnostyki awarii?

Odpowiedź nr 6:

Sformułowanie „ryczałt za jednorazowy dojazd do siedziby Zamawiającego” traktuje w przedmiocie kosztów ponoszonych przez Wykonawcę za przyjazd do siedziby Zamawiającego celem świadczenia usługi jednorazowego przeglądu okresowego.

Pytanie nr 7: dot. § 9 ust. 1 wzoru umowy

W związku z tym, że Zamawiający wyznaczył maksymalną wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, aż 10% wartości przedmiotu umowy, co przy tego typu zamówieniu stanowi znaczną wartość, prosimy o obniżenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o połowę, tj. do 5% wartości przedmiotu umowy.

Odpowiedź nr 7:

Nie. Nadto Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 8: dot. rozdziału II SIWZ:

Zwracamy się z prośbą o rezygnację z zawartego w w/w punkcie wymogu porządkowania przestrzeni dyskowej i bazy danych. Wyjaśniamy, iż w/w czynności nie są wykonywane przez inżynierów serwisowych, ale ze względu m.in. na ochronę danych pacjenta leży tylko i wyłącznie w zakresie Zamawiającego.

Odpowiedź nr 8:

Nie. Nadto Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 9: dot. rozdziału II SIWZ:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający w celu dbałości o zapewnienie należytej jakości usług podczas wykonywania zamówienia będzie wymagał, aby zamówienie było realizowane przez autoryzowanego przedstawiciela producenta sprzętu i / lub przez osoby posiadające szkolenia producenta do wykonywania napraw / przeglądów technicznych?

Odpowiedź nr 9:

Nie. Nadto Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 10: dot. § 8 ust. 1 pkt 2) i pkt 3) wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na:

2) „w przypadku opóźnienia w przystąpieniu do realizacji przeglądów technicznych sprzętów oraz urządzeń aparatury medycznej, kara umowna będzie wynosiła 1% szacunkowej wartości umowy w zakresie Pakietu nr, o której mowa w § 7 ust. 4 za każdy rozpoczęty dzień pozostawania w opóźnieniu w przystąpieniu do realizacji przeglądów technicznych sprzętów oraz urządzeń aparatury medycznej”,

3) w przypadku stwierdzonego nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, kara umowna będzie wynosiła 200,00 zł za każdy zaistniały przypadek”

Odpowiedź nr 10:

Nie. Nadto Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 11: dot. § 8 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka”?

Odpowiedź nr 11:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 12: dot. Pakietu nr 13

Prosimy o informację, czy z uwagi na inwazyjność wyrobów jakimi są diatermie elektrochirurgiczne dawkujące prąd do ciała pacjenta i związane z tym podwyższone ryzyko wystąpienia incydentu medycznego, Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy posiadania aktualnego upoważnienia (autoryzacji) od wytwórcy do świadczenia usług serwisowych i / lub dysponowania osobą posiadającą pisemne potwierdzenia odbycia szkolenia serwisowego u producenta urządzeń jak w Pakiecie nr 13 oraz okazywania w/w uprawnień na każde wezwanie Zamawiającego w trakcie realizacji postępowania i zamówienia? Ingerencja w aparaturę podmiotów i osób nieupoważnionych przez wytwórcę skutkować może ograniczeniem odpowiedzialności producenta za produkt.

Odpowiedź nr 12:

Nie.

Pytanie nr 13: dot. § 8 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy

Wnioskujemy o zmniejszenie kary umownej z 2,5% do 1% za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji przeglądów technicznych.

Odpowiedź nr 13:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 14: dot. § 2 ust. 5 wzoru umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie do w/w zapisu zdania: „Koszty nie mogą przekroczyć wartości danej umowy, w innym przypadku muszą być uprzednio zaakceptowane przez Wykonawcę.”. Czy Zamawiający może zmienić powyższy zapis na: „W przypadku, gdyby wskazany w SIWZ termin przeglądu technicznego nie mógł być lub nie został przez Wykonawcę dotrzymany, Zamawiający może zlecić wykonanie usługi innemu podmiotowi, który będzie posiadał kwalifikacje i doświadczenie odpowiadające zapisom przedmiotowej SIWZ, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty nie mogą przekroczyć wartości danej umowy, w innym przypadku muszą być uprzednio zaakceptowane przez Wykonawcę.”.

Odpowiedź nr 14:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 15: dot. § 8 ust. 2 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „W przypadku opóźnienia w przystąpieniu do realizacji przeglądów technicznych sprzętów oraz urządzeń aparatury medycznej, kara umowna będzie wynosiła 0,5% szacunkowej wartości umowy w zakresie Pakietu nr, o której mowa w § 7 ust. 4 za każdy rozpoczęty dzień pozostawiania w opóźnieniu w przystąpieniu do realizacji przeglądów technicznych sprzętów oraz urządzeń aparatury medycznej”.

Odpowiedź nr 15:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 16: dot. § 9 ust. 1 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10%?

Odpowiedź nr 16:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 17: dot. § 9 ust. 6 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od poniższego zapisu: „Jeżeli w trakcie realizacji umowy wysokość kwoty zabezpieczenia, z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu lub wygaśnie, Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie uzupełnić kwotę zabezpieczenia do wysokości wynikającej z postanowień umowy, pod rygorem zapłaty kary umownej odpowiadającej wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 4 umowy”. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę warunków formularza oferty w pkt 2, tj.: „Oferuję ryczałt jednorazowy za dojazd do siedziby Zamawiającego w kwocie.”

Odpowiedź nr 17:

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 18: dot. rozdziału I, działu 8., pkt 8.1. SIWZ

Czy Zamawiający uzna wartość 0 zł jako koszt dojazdu do Zamawiającego? Koszt dojazdu zostanie wliczony do ceny za przegląd techniczny densytometru. Nasza firma oferuje swoim klientom ceny ryczałtowe, które zawierają wszystkie koszty, tj. robociznę, dojazd, koszt hotelu inżyniera, paliwa itp. Nie rozgraniczamy kosztów robocizny i

kosztów dojazdu, ofertując klientom cenę za przegląd sprzętu medycznego. W związku z powyższym, czy Zamawiający uzna koszty ryczałtu, który zawierać będzie koszt przeglądu wraz ze wszystkimi kosztami, jakie Wykonawca musi ponieść?

Odpowiedź nr 18:

Nie. Wobec tego, że polski system monetarny nie przewiduje jednostek pieniężnych o nominale zero złotych, a także z uwagi na to, że ryczałt za jednorazowy dojazd do siedziby Zamawiającego stanowi jeden z kryterium oceny ofert, cena powinna być dodatnio wyrażona w złotych i groszach.

Pytanie nr 19: dot. Pakietu nr 17, poz. 9

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

- wykonanie, w ramach przeglądów okresowych, wymiany pakietów serwisowych, zalecanych / wymaganych przez producenta (np. filtry, uszczelki, akumulatory),
- wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych, zakwalifikowanych do ich wymiany podczas czynności serwisowych (używane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne oraz części zamienne będą nowe, pełnowartościowe oraz będą posiadać parametry techniczne odpowiadające parametrom technicznym materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dedykowanym danego rodzaju aparaturze, sprzętom lub urządzeniom przez ich producentów).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert, a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i / lub równego traktowania Wykonawców, prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na brak wskazania dokładnego modelu urządzenia przygotowanie porównywalnych i ważnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Prosimy o podanie pełnej nazwy modelu / typu defibrylatora Bene Heart. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia, czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia, tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nakazujących Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie podzespoły powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź nr 19:

Zamawiający informuje, że pełne i kompletne dane oraz informacje, o udzielenie których Wykonawca uprasza Zamawiającego w swoim pytaniu, zostały już precyzyjnie wskazane przez Zamawiającego w treści Załącznika nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 20: dot. Pakietu nr 17, poz. 9

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

- wykonanie, w ramach przeglądów okresowych, wymiany pakietów serwisowych, zalecanych / wymaganych przez producenta (np. filtry, uszczelki, akumulatory),
- wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych, zakwalifikowanych do ich wymiany podczas czynności serwisowych (używane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne oraz części zamienne będą nowe, pełnowartościowe oraz będą posiadać parametry techniczne odpowiadające parametrom technicznym materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dedykowanym danego rodzaju aparaturze, sprzętom lub urządzeniom przez ich producentów).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert, a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i / lub równego traktowania Wykonawców, prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta defibrylatora Bene Heart, wymiana poszczególnych części serwisowych, tj. akumulatora jest uwarunkowana jego stopniem zużycia. Zgodnie z treścią wskazanego powyżej zapisu SIWZ, przedmiot zamówienia obejmuje m.in. wymianę akumulatora. Wykonawca nie ma wiedzy na temat stopnia zużycia akumulatorów. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy i jeżeli tak to w jakiej ilości i dla których defibrylatorów Bene Heart Zamawiający wymaga w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany akumulatora. Prosimy o jednoznaczne wytyczne. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stanu zużycia akumulatora, prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia akumulatorów w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana akumulatorów będzie dokonywana według stanu ich zużycia zgodnie z zaleceniami po przeglądzie. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia, tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nakazujących Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć

wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź nr 20:

Zamawiający informuje, że w ramach realizowanej przez Wykonawcę usługi przeglądów technicznych sprzętów i urządzeń aparatury medycznej, Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do wymiany każdego akumulatora w defibrylatorze.

Pytanie nr 21: dot. Pakietu nr 17, poz. 6-8

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

- wykonanie, w ramach przeglądów okresowych, wymiany pakietów serwisowych, zalecanych / wymaganych przez producenta (np. filtry, uszczelki, akumulatory),
- wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych, zakwalifikowanych do ich wymiany podczas czynności serwisowych (używane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne oraz części zamienne będą nowe, pełnowartościowe oraz będą posiadać parametry techniczne odpowiadające parametrom technicznym materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dedykowanym danego rodzaju aparaturze, sprzętom lub urządzeniom przez ich producentów).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert, a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i / lub równego traktowania Wykonawców, prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta defibrylatora PIC 40, wymiana poszczególnych części serwisowych, tj. akumulatora jest uwarunkowana jego stopniem zużycia. Zgodnie z treścią wskazanego powyżej zapisu SIWZ, przedmiot zamówienia obejmuje m.in. wymianę akumulatora. Wykonawca nie ma wiedzy na temat stopnia zużycia akumulatorów. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy i jeżeli tak to w jakiej ilości i dla których defibrylatorów PIC 40 Zamawiający wymaga w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany akumulatora. Prosimy o jednoznaczne wytyczne. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stanu zużycia akumulatora, prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia akumulatorów w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana akumulatorów będzie dokonywana według stanu ich zużycia zgodnie z zaleceniami po przeglądzie. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia, tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nakazujących Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź nr 21:

Zamawiający informuje, że w ramach realizowanej przez Wykonawcę usługi przeglądów technicznych sprzętów i urządzeń aparatury medycznej, Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do wymiany każdego akumulatora w defibrylatorze.

Pytanie nr 22: dot. Pakietu nr 17, poz. 12

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

- wykonanie, w ramach przeglądów okresowych, wymiany pakietów serwisowych, zalecanych / wymaganych przez producenta (np. filtry, uszczelki, akumulatory),
- wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych, zakwalifikowanych do ich wymiany podczas czynności serwisowych (używane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne oraz części zamienne będą nowe, pełnowartościowe oraz będą posiadać parametry techniczne odpowiadające parametrom technicznym materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dedykowanym danego rodzaju aparaturze, sprzętom lub urządzeniom przez ich producentów).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert, a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i / lub równego traktowania Wykonawców, prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta defibrylatora DMS 730, wymiana poszczególnych części serwisowych, tj. akumulatora jest uwarunkowana jego stopniem zużycia. Zgodnie z treścią wskazanego powyżej zapisu SIWZ, przedmiot zamówienia obejmuje m.in. wymianę akumulatora. Wykonawca nie ma wiedzy na temat stopnia zużycia akumulatorów. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy i jeżeli tak to w jakiej ilości i dla których defibrylatorów DMS 730 Zamawiający wymaga w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany akumulatora. Prosimy o jednoznaczne wytyczne. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować

stanu zużycia akumulatora, prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia akumulatorów w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana akumulatorów będzie dokonywana według stanu ich zużycia zgodnie z zaleceniami po przeglądzie. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia, tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nakazujących Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź nr 22:

Zamawiający informuje, że w ramach realizowanej przez Wykonawcę usługi przeglądów technicznych sprzętów i urządzeń aparatury medycznej, Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do wymiany każdego akumulatora w defibrylatorze.

Pytanie nr 23: dot. Pakietu nr 17, poz. 13-14

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

- wykonanie, w ramach przeglądów okresowych, wymiany pakietów serwisowych, zalecanych / wymaganych przez producenta (np. filtry, uszczelki, akumulatory),
- wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych, zakwalifikowanych do ich wymiany podczas czynności serwisowych (używane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne oraz części zamienne będą nowe, pełnowartościowe oraz będą posiadać parametry techniczne odpowiadające parametrom technicznym materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dedykowanym danego rodzaju aparaturze, sprzętom lub urządzeniom przez ich producentów).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert, a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i / lub równego traktowania Wykonawców, prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta defibrylatora DG 4000, wymiana poszczególnych części serwisowych, tj. akumulatora jest uwarunkowana jego stopniem zużycia. Zgodnie z treścią wskazanego powyżej zapisu SIWZ, przedmiot zamówienia obejmuje m.in. wymianę akumulatora. Wykonawca nie ma wiedzy na temat stopnia zużycia akumulatorów. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy i jeżeli tak to w jakiej ilości i dla których defibrylatorów DG 4000 Zamawiający wymaga w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany akumulatora. Prosimy o jednoznaczne wytyczne. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stanu zużycia akumulatora, prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia akumulatorów w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana akumulatorów będzie dokonywana według stanu ich zużycia zgodnie z zaleceniami po przeglądzie. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia, tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nakazujących Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź nr 23:

Zamawiający informuje, że w ramach realizowanej przez Wykonawcę usługi przeglądów technicznych sprzętów i urządzeń aparatury medycznej, Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do wymiany każdego akumulatora w defibrylatorze.

Pytanie nr 24: dot. Pakietu nr 17, poz. 1-5

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

- wykonanie, w ramach przeglądów okresowych, wymiany pakietów serwisowych, zalecanych / wymaganych przez producenta (np. filtry, uszczelki, akumulatory),
- wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych, zakwalifikowanych do ich wymiany podczas czynności serwisowych (używane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne oraz części zamienne będą nowe, pełnowartościowe oraz będą posiadać parametry techniczne odpowiadające parametrom technicznym materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dedykowanym danego rodzaju aparaturze, sprzętom lub urządzeniom przez ich producentów).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert, a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i / lub równego traktowania Wykonawców, prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z

wytycznymi określonymi przez producenta defibrylatora LifePak 20, wymiana poszczególnych części serwisowych, tj. akumulatora jest uwarunkowana jego stopniem zużycia. Zgodnie z treścią wskazanego powyżej zapisu SIWZ, przedmiot zamówienia obejmuje m.in. wymianę akumulatora. Wykonawca nie ma wiedzy na temat stopnia zużycia akumulatorów. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy i jeżeli tak to w jakiej ilości i dla których defibrylatorów LifePak 20 Zamawiający wymaga w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany akumulatora. Prosimy o jednoznaczne wytyczne. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stanu zużycia akumulatora, prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia akumulatorów w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana akumulatorów będzie dokonywana według stanu ich zużycia zgodnie z zaleceniami po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia, tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nakazujących Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź nr 24:

Zamawiający informuje, że w ramach realizowanej przez Wykonawcę usługi przeglądów technicznych sprzętów i urządzeń aparatury medycznej, Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do wymiany każdego akumulatora w defibrylatorze.

Pytanie nr 25: dot. Pakietu nr 17, poz. 1-5

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

- wykonanie, w ramach przeglądów okresowych, wymiany pakietów serwisowych, zalecanych / wymaganych przez producenta (np. filtry, uszczelki, akumulatory),
- wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych, zakwalifikowanych do ich wymiany podczas czynności serwisowych (używane będą posiadać parametry techniczne odpowiadające parametrom będą nowe, pełnowartościowe oraz będą posiadać parametry techniczne odpowiadające parametrom technicznym materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dedykowanym danego rodzaju aparaturze, sprzętom lub urządzeniom przez ich producentów).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert, a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i / lub równego traktowania Wykonawców, prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta defibrylatora LifePak 20, wymiana poszczególnych części serwisowych, tj. baterii podtrzymania pamięci wymagana jest co 48 miesięcy. Wykonawca nie ma wiedzy na temat ostatniej daty wymiany baterii podtrzymania pamięci. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy i jeżeli tak to w jakiej ilości i dla których defibrylatorów LifePak 20 Zamawiający wymaga w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany baterii podtrzymania pamięci. Prosimy o jednoznaczne wytyczne. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian baterii podtrzymania pamięci, prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia, tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nakazujących Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź nr 25:

Zamawiający informuje, że w ramach realizowanej przez Wykonawcę usługi przeglądów technicznych sprzętów i urządzeń aparatury medycznej, Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do wymiany każdej baterii podtrzymania pamięci w defibrylatorze.

Pytanie nr 26: dot. Pakietu nr 17, poz. 10

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

- wykonanie, w ramach przeglądów okresowych, wymiany pakietów serwisowych, zalecanych / wymaganych przez producenta (np. filtry, uszczelki, akumulatory),
- wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych, zakwalifikowanych do ich wymiany podczas czynności serwisowych (używane będą posiadać parametry techniczne odpowiadające parametrom będą nowe, pełnowartościowe oraz będą posiadać parametry techniczne odpowiadające parametrom technicznym materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dedykowanym danego rodzaju aparaturze, sprzętom lub urządzeniom przez ich producentów).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert, a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i / lub równego traktowania Wykonawców, prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta defibrylatora Bene Heart D3, wymiana poszczególnych części serwisowych, tj. akumulatora jest uwarunkowana jego stopniem zużycia. Zgodnie z treścią wskazanego powyżej zapisu SIWZ, przedmiot zamówienia obejmuje m.in. wymianę akumulatora. Wykonawca nie ma wiedzy na temat stopnia zużycia akumulatorów. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy i jeżeli tak to w jakiej ilości i dla których defibrylatorów Bene Heart D3 Zamawiający wymaga w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany akumulatora. Prosimy o jednoznaczne wytyczne. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stanu zużycia akumulatora, prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia akumulatorów w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana akumulatorów będzie dokonywana według stanu ich zużycia zgodnie z zaleceniami po przeglądzie. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia, tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nakazujących Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź nr 26:

Zamawiający informuje, że w ramach realizowanej przez Wykonawcę usługi przeglądów technicznych sprzętów i urządzeń aparatury medycznej, Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do wymiany każdego akumulatora w defibrylatorze.

Pytanie nr 27: dot. Pakietu nr 17, poz. 11

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

- wykonanie, w ramach przeglądów okresowych, wymiany pakietów serwisowych, zalecanych / wymaganych przez producenta (np. filtry, uszczelki, akumulatory),
- wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych, zakwalifikowanych do ich wymiany podczas czynności serwisowych (używane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne oraz części zamienne będą nowe, pełnowartościowe oraz będą posiadać parametry techniczne odpowiadające parametrom technicznym materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dedykowanym danego rodzaju aparaturze, sprzętom lub urządzeniom przez ich producentów).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert, a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i / lub równego traktowania Wykonawców, prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta defibrylatora ZOLL M Series, wymiana poszczególnych części serwisowych, tj. akumulatora jest uwarunkowana jego stopniem zużycia. Zgodnie z treścią wskazanego powyżej zapisu SIWZ, przedmiot zamówienia obejmuje m.in. wymianę akumulatora. Wykonawca nie ma wiedzy na temat stopnia zużycia akumulatorów. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy i jeżeli tak to w jakiej ilości i dla których defibrylatorów ZOLL M Series Zamawiający wymaga w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany akumulatora. Prosimy o jednoznaczne wytyczne. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stanu zużycia akumulatora, prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia akumulatorów w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana akumulatorów będzie dokonywana według stanu ich zużycia zgodnie z zaleceniami po przeglądzie. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia, tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nakazujących Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź nr 27:

Zamawiający informuje, że w ramach realizowanej przez Wykonawcę usługi przeglądów technicznych sprzętów i urządzeń aparatury medycznej, Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do wymiany każdego akumulatora w defibrylatorze.

Pytanie nr 28: dot. Pakietu nr 18, poz. 1-3

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

- wykonanie, w ramach przeglądów okresowych, wymiany pakietów serwisowych, zalecanych / wymaganych przez producenta (np. filtry, uszczelki, akumulatory),

- wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych, zakwalifikowanych do ich wymiany podczas czynności serwisowych (używane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne oraz części zamienne będą nowe, pełnowartościowe oraz będą posiadać parametry techniczne odpowiadające parametrom technicznym materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dedykowanym danego rodzaju aparaturze, sprzętom lub urządzeniom przez ich producentów).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert, a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i / lub równego traktowania Wykonawców, prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatów Fabius GS/GS Premium, wymiana poszczególnych części serwisowych uwarunkowana jest określonym czasookresem. Zgodnie z treścią wskazanego powyżej zapisu SIWZ, przedmiot zamówienia obejmuje m.in. wymiany pakietów serwisowych. Wykonawca nie ma wiedzy na temat ostatnio wykonywanych usług i wymienianych części serwisowych. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy i jeżeli tak to w jakiej ilości i dla których aparatów Zamawiający wymaga w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany:

- ◆ Drager Fabius GS 1 year Service Set [roczny zestaw serwisowy, wymagana wymiana co 12 m-cy]
- ◆ Drager Fabius GS 2 years Service Set [dwuletni zestaw serwisowy, wymagana wymiana co 24 m-ce]
- ◆ Drager Fabius GS 3 years Service Set [trzyletni zestaw serwisowy, wymagana wymiana co 36 m-cy]

Prosimy o jednoznaczne wytyczne. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować historii wymiany poszczególnych części, prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana zestawów serwisowych będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia, tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nakazujących Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.


Odpowiedź nr 28:

Zamawiający informuje, że w ramach realizowanej przez Wykonawcę usługi przeglądów technicznych sprzętów i urządzeń aparatury medycznej, Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do wymiany każdego zestawu 12-miesięcznego i każdego zestawu 24-miesięcznego.


Pytanie nr 29: dot. Pakietu nr 18, poz. 1-3

Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia o informację, jaki rodzaj obiegu okrężnego znajduje się przy każdym z aparatów Fabius GS/GS Premium. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne, ponieważ dwuletni zestaw serwisowy występuje w dwóch wersjach w zależności od rodzaju obiegu okrężnego, jaki występuje w danym aparacie. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej. Poniżej przedstawiamy zdjęcie każdego z obiegów z prośbą o wskazanie, który z nich występuje w aparacie z poz. 1-3 Pakietu nr 18.

Obieg nr 1

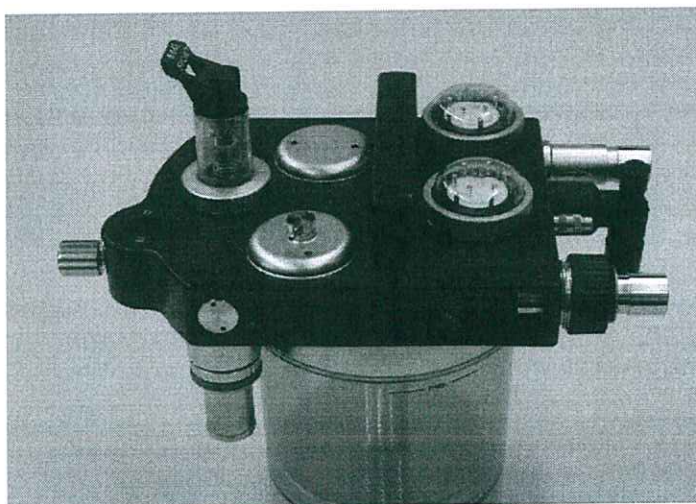

Obieg nr 2

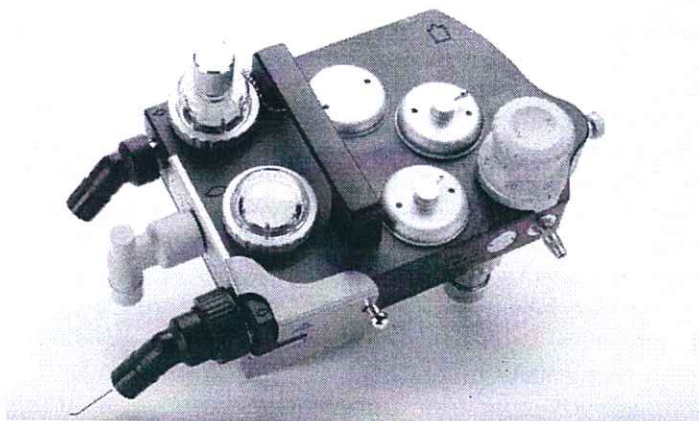

Odpowiedź nr 29:

Zamawiający informuje, że w aparacie z poz. 1-3 Pakietu nr 18 występuje przedstawiony powyżej obieg nr 2.

Pytanie nr 30: dot. Pakietu nr 18, poz. 1-3

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

- wykonanie, w ramach przeglądów okresowych, wymiany pakietów serwisowych, zalecanych / wymaganych przez producenta (np. filtry, uszczelki, akumulatory),
- wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych, zakwalifikowanych do ich wymiany podczas czynności serwisowych (używane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne oraz części zamienne będą nowe, pełnowartościowe oraz będą posiadać parametry techniczne odpowiadające parametrom technicznym materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dedykowanym danego rodzaju aparaturze, sprzętom lub urządzeniom przez ich producentów).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert, a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i / lub równego traktowania Wykonawców, prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatów Fabius GS/GS, Premium wymiana poszczególnych części serwisowych uwarunkowana jest stanem zużycia. Zgodnie z treścią wskazanego powyżej zapisu SIWZ, przedmiot zamówienia obejmuje m.in. wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych. Wykonawca nie ma wiedzy na temat ostatnio wykonywanych usług i wymienianych części serwisowych. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy i jeżeli tak to w jakiej ilości i dla których aparatów Zamawiający wymaga w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany:

- ◆ czujnika przepływu (producent zaleca wymianę według stanu zużycia)
- ◆ czujnika tlenu producent zaleca wymianę według stanu zużycia)

Prosimy o jednoznaczne wytyczne. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować historii wymiany poszczególnych części, prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana czujnika przepływu i czujnika tlenu będzie dokonywana według stanu ich zużycia zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia, tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nakazujących Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź nr 30:

Zamawiający informuje, że w ramach realizowanej przez Wykonawcę usługi przeglądów technicznych sprzętów i urządzeń aparatury medycznej, Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do wymiany każdego czujnika przepływu oraz każdego czujnika tlenu w aparacie Fabius GS/GS.

Pytanie nr 31: dot. Pakietu nr 18, poz. 4

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

- wykonanie, w ramach przeglądów okresowych, wymiany pakietów serwisowych, zalecanych / wymaganych przez producenta (np. filtry, uszczelki, akumulatory),
- wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych, zakwalifikowanych do ich wymiany podczas czynności serwisowych (używane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne oraz części zamienne będą nowe, pełnowartościowe oraz będą posiadać parametry techniczne odpowiadające parametrom technicznym materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dedykowanym danego rodzaju aparaturze, sprzętom lub urządzeniom przez ich producentów).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert, a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i / lub równego traktowania Wykonawców, prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatów Fabius TIRO, wymiana poszczególnych części serwisowych uwarunkowana jest określonym czasookresem. Zgodnie z treścią wskazanego powyżej zapisu SIWZ, przedmiot zamówienia obejmuje m.in. wymiany pakietów serwisowych, filtrów, czy uszczelki. Wykonawca nie ma wiedzy na temat ostatnio wykonywanych usług i wymienianych części serwisowych. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy i jeżeli tak to w jakiej ilości i dla których aparatów Zamawiający wymaga w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany:

Element	Ilość	Wymiana
VALVE DISK (płatek ceramiczny)	2	co 12 miesięcy
Diaphragm, cup (miech)	1	co 12 miesięcy
GASKET (uszczelka)	1	co 12 miesięcy
BACTERIA FILTER (filtr bakteryjny)	2	co 12 miesięcy
O-RING SEAL (uszczelka gniazda parownika)	2	co 12 miesięcy
Gaskets (uszczelka)	1	co 24 miesiące
VALVE DISKS (płatek ceramiczny)	2	co 24 miesiące
DIAPHRAGMS (membrana 1)	1	co 24 miesiące
DIAPHRAGMS (membrana 2)	1	co 24 miesiące
O-RING 105 x 4 (uszczelka)	1	co 36 miesięcy
Batterie,Lithium 3V/260mAh (bateria podtrzymania pamięci)	1	co 36 miesięcy
Lead-acid battery 12V/3.5AH (akumulator)	2	co 36 miesięcy
Diaphragm, Pisten (membrana 3)	1	co 36 miesięcy

Prosimy o jednoznaczne wytyczne. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować historii wymiany poszczególnych części, prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że ich wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia, tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nakazujących Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź nr 31:

Zamawiający informuje, że w ramach realizowanej przez Wykonawcę usługi przeglądów technicznych sprzętów i urządzeń aparatury medycznej, Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do wymiany każdej z wyszczególnionych przez Wykonawcę w jego pytaniu części serwisowej w aparacie Fabius TRIO.

Pytanie nr 32: dot. Pakietu nr 18, poz. 4

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

- wykonanie, w ramach przeglądów okresowych, wymiany pakietów serwisowych, zalecanych / wymaganych przez producenta (np. filtry, uszczelki, akumulatory),

- wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych, zakwalifikowanych do ich wymiany podczas czynności serwisowych (używane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne oraz części zamienne będą nowe, pełnowartościowe oraz będą posiadać parametry techniczne odpowiadające parametrom technicznym materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dedykowanym danego rodzaju aparaturze, sprzętom lub urządzeniom przez ich producentów).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert, a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i / lub równego traktowania Wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatów Fabius TIRO, wymiana poszczególnych części serwisowych uwarunkowana jest stanem zużycia. Zgodnie z treścią wskazanego powyżej zapisu SIWZ, przedmiot zamówienia obejmuje m.in. wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych. Wykonawca nie ma wiedzy na temat ostatnio wykonywanych usług i wymienianych części serwisowych. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy i jeżeli tak to w jakiej ilości i dla których aparatów Zamawiający wymaga w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany:

- ♦ czujnik przepływu (producent zaleca wymianę według stanu zużycia)
- ♦ czujnika tlenu (producent zaleca wymianę według stanu zużycia)

Prosimy o jednoznaczne wytyczne. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować historii wymiany poszczególnych części, prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana czujnika przepływu i czujnika tlenu będzie dokonywana według stanu ich zużycia zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia, tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nakazujących Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź nr 32:

Zamawiający informuje, że w ramach realizowanej przez Wykonawcę usługi przeglądów technicznych sprzętów i urządzeń aparatury medycznej, Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do wymiany każdego czujnika przepływu oraz każdego czujnika tlenu w aparacie Fabius TRIO.

Pytanie nr 33: dot. Pakietu nr 20, poz. 3

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

- wykonanie, w ramach przeglądów okresowych, wymiany pakietów serwisowych, zalecanych / wymaganych przez producenta (np. filtry, uszczelki, akumulatory),
- wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych, zakwalifikowanych do ich wymiany podczas czynności serwisowych (używane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne oraz części zamienne będą nowe, pełnowartościowe oraz będą posiadać parametry techniczne odpowiadające parametrom technicznym materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dedykowanym danego rodzaju aparaturze, sprzętom lub urządzeniom przez ich producentów).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert, a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i / lub równego traktowania Wykonawców, prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratorów SAVINA, wymiana poszczególnych części serwisowych uwarunkowana jest określonym czasem. Zgodnie z treścią wskazanego powyżej zapisu SIWZ, przedmiot zamówienia obejmuje m.in. wymiany pakietów serwisowych, filtrów czy uszczelk. Wykonawca nie ma wiedzy na temat ostatnio wykonywanych usług i wymienianych części serwisowych. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy i jeżeli tak to w jakiej ilości i dla których aparatów Zamawiający wymaga w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany:

Element	Odstęp czasu
Drager Savina Service Set 1 year (roczny zestaw serwisowy)	co 12 miesięcy
Drager Savina Service Set 2 years (dwuletni zestaw)	co 24 miesiące

serwisowy)	
Drager Savina Service Set 6 years (sześćoletni zestaw serwisowy)	co 72 miesiące

Prosimy o jednoznaczne wytyczne. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować historii wymiany poszczególnych części, prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że ich wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia, tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nakazujących Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź nr 33:

Zamawiający informuje, że w ramach realizowanej przez Wykonawcę usługi przeglądów technicznych sprzętów i urządzeń aparatury medycznej, Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do wymiany każdego 24-miesięcznego zestawu serwisowego (tj. service set 2 years) w respiratorze SAFINA.

Pytanie nr 34: dot. Pakietu nr 20, poz. 3

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

- wykonanie, w ramach przeglądów okresowych, wymiany pakietów serwisowych, zalecanych / wymaganych przez producenta (np. filtry, uszczelki, akumulatory),
- wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych, zakwalifikowanych do ich wymiany podczas czynności serwisowych (używane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne oraz części zamienne będą nowe, pełnowartościowe oraz będą posiadać parametry techniczne odpowiadające parametrom technicznym materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dedykowanym danego rodzaju aparaturze, sprzętom lub urządzeniom przez ich producentów).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert, a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i / lub równego traktowania Wykonawców, prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratorów SAVINA, wymiana poszczególnych części serwisowych uwarunkowana jest stanem zużycia. Zgodnie z treścią wskazanego powyżej zapisu SIWZ, przedmiot zamówienia obejmuje m.in. wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych. Wykonawca nie ma wiedzy na temat ostatnio wykonywanych usług i wymienianych części serwisowych. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy i jeżeli tak to w jakiej ilości i dla których respiratorów Zamawiający wymaga w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany:

- ◆ czujniki tlenu OxyTrace 1 kpl. = 2 szt. (producent zaleca wymianę według stanu zużycia)
- ◆ czujnik przepływu (producent zaleca wymianę według stanu zużycia)

Prosimy o jednoznaczne wytyczne. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować historii wymiany poszczególnych części, prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana czujnika przepływu i czujnika tlenu będzie dokonywana według stanu ich zużycia zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia, tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nakazujących Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź nr 34:

Zamawiający informuje, że w ramach realizowanej przez Wykonawcę usługi przeglądów technicznych sprzętów i urządzeń aparatury medycznej, Wykonawca zobowiązany będzie do dwukrotnej wymiany każdego czujnika przepływu oraz każdego czujnika tlenu w respiratorze SAVINA.

Pytanie nr 35: dot. Pakietu nr 20, poz. 1-2

W celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i / lub równego traktowania Wykonawców prosimy o wyrażenie zgody na wydzielenie z Pakietu nr 20 pozycji nr 1-2, tj. respiratora Drager Evita V300 do nowo utworzonego odrębnego Pakietu nr 20a. Pozytywne przychylenie się do naszego wniosku umożliwi złożenie ważnej oferty

przetargowej większej ilości Wykonawców i w znaczny sposób przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności przedmiotowego postępowania.

Odpowiedź nr 35:

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 36: dot. Pakietu nr 21, poz. 1

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

- wykonanie, w ramach przeglądów okresowych, wymiany pakietów serwisowych, zalecanych / wymaganych przez producenta (np. filtry, uszczelki, akumulatory),
- wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych, zakwalifikowanych do ich wymiany podczas czynności serwisowych (używane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne oraz części zamienne będą nowe, pełnowartościowe oraz będą posiadać parametry techniczne odpowiadające parametrom technicznym materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dedykowanym danego rodzaju aparaturze, sprzętom lub urządzeniom przez ich producentów).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert, a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i / lub równego traktowania Wykonawców, prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratorów Bennett 760, wymiana poszczególnych części serwisowych uwarunkowana jest określonym czasookresem lub ilością przepracowanych roboczogodzin. Zgodnie z treścią wskazanego powyżej zapisu SIWZ, przedmiot zamówienia obejmuje m.in. wymiany pakietów serwisowych, filtrów czy uszczelk. Wykonawca nie ma wiedzy na temat ostatnio wykonywanych usług i wymienianych części serwisowych. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy i jeżeli tak to w jakiej ilości i dla których aparatów Zamawiający wymaga w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany:

Element	Producent wymaga wymiany (odstęp czasu)
15,000-hour preventive maintenance kit (zestaw serwisowy po przepracowaniu 15 tys. godzin)	co 15 000 godzin
30,000-hour preventive maintenance kit (zestaw serwisowy po przepracowaniu 30 tys. godzin)	co 30 000 godzin
akumulator wewnętrzny	co 24 miesiące
filter PEEP pump air intake (filtr PEEP)	co 12 miesięcy lub 15 000 godzin

Prosimy o jednoznaczne wytyczne. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować historii wymiany poszczególnych części lub ilości przepracowanych godzin, prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że ich wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia, tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nakazujących Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź nr 36:

Zamawiający informuje, że w ramach realizowanej przez Wykonawcę usługi przeglądów technicznych sprzętów i urządzeń aparatury medycznej, Wykonawca zobowiązany będzie do dwukrotnej wymiany każdego 15 000-godzinowego zestawu serwisowego (tj. 15,000-hour preventive maintenance kit) oraz do każdorazowej wymiany każdego filtra PEEP (tj. filter PEEP pump air intake) w respiratorze Bennett 760.

Pytanie nr 37: dot. Pakietu nr 21, poz. 1

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

- wykonanie, w ramach przeglądów okresowych, wymiany pakietów serwisowych, zalecanych / wymaganych przez producenta (np. filtry, uszczelki, akumulatory),
- wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych, zakwalifikowanych do ich wymiany podczas czynności serwisowych (używane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne oraz części zamienne będą nowe, pełnowartościowe oraz będą posiadać parametry techniczne odpowiadające parametrom technicznym materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dedykowanym danego rodzaju aparaturze, sprzętom lub urządzeniom przez ich producentów).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert, a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i / lub równego traktowania Wykonawców, prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratorów Bennett 760, wymiana poszczególnych części serwisowych uwarunkowana jest stanem zużycia lub określonym czasookresem. Zgodnie z treścią wskazanego powyżej zapisu SIWZ, przedmiot zamówienia obejmuje m.in. wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych. Wykonawca nie ma wiedzy na temat ostatnio wykonywanych usług i wymienianych części serwisowych. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy i jeżeli tak to w jakiej ilości i dla których respiratorów Zamawiający wymaga w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany:

- ◆ czujniki tlenu (producent zaleca wymianę, co 12 m-cy lub jeżeli stan zużycia tego wymaga)

Prosimy o jednoznaczne wytyczne. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować historii wymiany poszczególnych części, prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana czujnika tlenu będzie dokonywana według stanu ich zużycia zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia, tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nakazujących Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź nr 37:

Zamawiający informuje, że w ramach realizowanej przez Wykonawcę usługi przeglądów technicznych sprzętów i urządzeń aparatury medycznej, Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do wymiany każdego czujnika tlenu w respiratorze Bennett 760.

Pytanie nr 38: dot. Pakietu nr 21, poz. 2

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

- wykonanie, w ramach przeglądów okresowych, wymiany pakietów serwisowych, zalecanych / wymaganych przez producenta (np. filtry, uszczelki, akumulatory),
- wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych, zakwalifikowanych do ich wymiany podczas czynności serwisowych (używane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne oraz części zamienne będą nowe, pełnowartościowe oraz będą posiadać parametry techniczne odpowiadające parametrom technicznym materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dedykowanym danego rodzaju aparaturze, sprzętom lub urządzeniom przez ich producentów).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert, a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i / lub równego traktowania Wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratorów Bennett 840, wymiana poszczególnych części serwisowych uwarunkowana jest określonym czasookresem lub ilością przepracowanych roboczogodzin. Zgodnie z treścią wskazanego powyżej zapisu SIWZ, przedmiot zamówienia obejmuje m.in. wymiany pakietów serwisowych, filtrów czy uszczelk. Wykonawca nie ma wiedzy na temat ostatnio wykonywanych usług i wymienianych części serwisowych. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy i jeżeli tak to w jakiej ilości i dla których aparatów Zamawiający wymaga w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany:

Element	Odstęp czasu
oxygen sensor (czujnik tlenu)	co 12 miesięcy lub jeżeli stan zużycia tego wymaga
BPS battery pack (pakiet akumulatorów)	co 24 miesiące
10K PM KIT FOR THE 10.4 (zestaw serwisowy Puritan Bennett 840 10K)	co 10000 godzin

Prosimy o jednoznaczne wytyczne. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować historii wymiany poszczególnych części lub ilości przepracowanych godzin, prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że ich wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia, tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nakazujących Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na

przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź nr 38:

Zamawiający informuje, że w ramach realizowanej przez Wykonawcę usługi przeglądów technicznych sprzętów i urządzeń aparatury medycznej, Wykonawca zobowiązany będzie do jednokrotnej wymiany każdego pakietu akumulatorów (tj. BPS battery pack), a także do każdorazowej wymiany każdego czujnika tlenu (tj. oxygen sensor) oraz każdego zestawu serwisowego Puritan Bennett 840 10K (tj. 10K PM KIT FOR THE 10.4) w respiratorze Bennett 840.

Pytanie nr 39: dot. Pakietu nr 21, poz. 2

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

- wykonanie, w ramach przeglądów okresowych, wymiany pakietów serwisowych, zalecanych / wymaganych przez producenta (np. filtry, uszczelki, akumulatory),
- wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych, zakwalifikowanych do ich wymiany podczas czynności serwisowych (używane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne oraz części zamienne będą nowe, pełnowartościowe oraz będą posiadać parametry techniczne odpowiadające parametrom technicznym materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dedykowanym danego rodzaju aparaturze, sprzętom lub urządzeniom przez ich producentów).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert, a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i / lub równego traktowania Wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratorów Bennett 840, wymiana poszczególnych części serwisowych uwarunkowana jest stanem zużycia lub określonym czasookresem. Zgodnie z treścią wskazanego powyżej zapisu SIWZ, przedmiot zamówienia obejmuje m.in. wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych. Wykonawca nie ma wiedzy na temat ostatnio wykonywanych usług i wymienianych części serwisowych. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy i jeżeli tak to w jakiej ilości i dla których respiratorów Zamawiający wymaga w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany:

- ♦ czujniki tlenu (producent zaleca wymianę, co 12 m-cy lub jeżeli stan zużycia tego wymaga)

Prosimy o jednoznaczne wytyczne. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować historii wymiany poszczególnych części, prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana czujnika tlenu będzie dokonywana według stanu ich zużycia zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia, tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nakazujących Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź nr 39:

Zamawiający informuje, że w ramach realizowanej przez Wykonawcę usługi przeglądów technicznych sprzętów i urządzeń aparatury medycznej, Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do wymiany każdego czujnika tlenu w respiratorze Bennett 840.

Pytanie nr 40: Pakiet 21, poz. 3-4

W celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i / lub równego traktowania Wykonawców, prosimy o wyrażenie zgody na wydzielenie z Pakietu nr 21, poz. nr 3-4, tj. respiratora eVent Inspiration do nowo utworzonego odrębnego Pakietu nr 21a. Pozytywne przychylenie się do naszego wniosku umożliwi złożenie ważnej oferty przetargowej większej ilości Wykonawców i w ten sposób przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności przedmiotowego postępowania.

Odpowiedź nr 40:

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 41: dot. Pakietu nr 21, poz. 3-4

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

- wykonanie, w ramach przeglądów okresowych, wymiany pakietów serwisowych, zalecanych / wymaganych przez producenta (np. filtry, uszczelki, akumulatory),

- wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych, zakwalifikowanych do ich wymiany podczas czynności serwisowych (używane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne oraz części zamienne będą nowe, pełnowartościowe oraz będą posiadać parametry techniczne odpowiadające parametrom technicznym materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dedykowanym danego rodzaju aparaturze, sprzętom lub urządzeniom przez ich producentów).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert, a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i / lub równego traktowania Wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratorów e-Vent Inspiration, wymiana poszczególnych części serwisowych uwarunkowana jest określonym czasookresem lub stanem zużycia. Zgodnie z treścią wskazanego powyżej zapisu SIWZ, przedmiot zamówienia obejmuje m.in. wymiany pakietów serwisowych, filtrów czy uszczelek. Wykonawca nie ma wiedzy na temat ostatnio wykonywanych usług i wymienianych części serwisowych. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy i jeżeli tak to w jakiej ilości i dla których aparatów Zamawiający wymaga w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany:

Element	Odstęp czasu
O2 Sensor (czujnik tlenu)	co 12 miesięcy
gas inlet filters (zestaw filtrów 2 szt.)	co 12 miesięcy
internal battery (bateria wewnętrzna)	co 24 miesiące
exhalation membrane (membrana)	jeżeli stan zużycia tego wymaga

Prosimy o jednoznaczne wytyczne. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować historii wymiany poszczególnych części, prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że ich wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia, tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nakazujących Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź nr 41:

Zamawiający informuje, że w ramach realizowanej przez Wykonawcę usługi przeglądów technicznych sprzętów i urządzeń aparatury medycznej, Wykonawca zobowiązany będzie do jednokrotnej wymiany każdej baterii wewnętrznej (tj. internal battery), a także do każdorazowej wymiany każdego czujnika tlenu (tj. O2 sensor), każdego zestawu filtrów (tj. gas inlet filters) oraz każdej membrany (tj. exhalation membrane) w respiratorze e-Vent Inspiration.

Pytanie nr 42: dot. rozdziału II SIWZ

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający odstąpi od wymogu aktualizacji software'u systemowego i aplikacyjnego z uwagi na fakt, że tego rodzaju czynności oraz dostęp posiada bezpośredni producent lub jego autoryzowany przedstawiciel. Tego rodzaju wymóg wyklucza zupełnie udział w postępowaniu Wykonawców posiadających pełną zdolność do rzetelnej realizacji przedmiotowego zamówienia. Tym samym powyższy wymóg aktualizacji sprawia, że postępowanie ukierunkowane jest na jednego konkretnego Wykonawcę. Warto w tym miejscu podkreślić, że tego rodzaju wymagania powinny być zlecane poza procedurami przetargowymi w procedurach niekonkurencyjnych, poza standardowymi czynnościami serwisowymi lub konserwacyjnymi. Pozostawienie wymogu aktualizacji oprogramowania narusza w sposób istotny zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, tj. przepis art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź nr 42:

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 43: dot. Pakietu nr 21

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyłączenie z Pakietu nr 21 i utworzenie nowego dla poz. 3 i 4, tj. respiratorów Inspiration E-vent.

Odpowiedź nr 43:

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Dodatkowo, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że działając w oparciu o dyspozycję wyartykułowaną przez ustawodawcę w treści art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wyznacza nowy następujący termin składania i otwarcia ofert:

- termin składania ofert: 28.06.2019 r., godz. 11:30,
- termin otwarcia ofert: 28.06.2019 r., godz. 12:00.

